


樹脂(プラスチック)中の高分子量型ヒンダードアミン系光安定剤(HALS)の定量分析が可能です。

製品(成形品)における配合量の確認、実際に現場(屋外)で使用した後の含有量の確認など、定量に関する情報をご提供します。

また、低分子量型HALSを含む、HALS全般の定性・定量分析も可能です。

分析例：抽出 → HPLC測定(CAD)

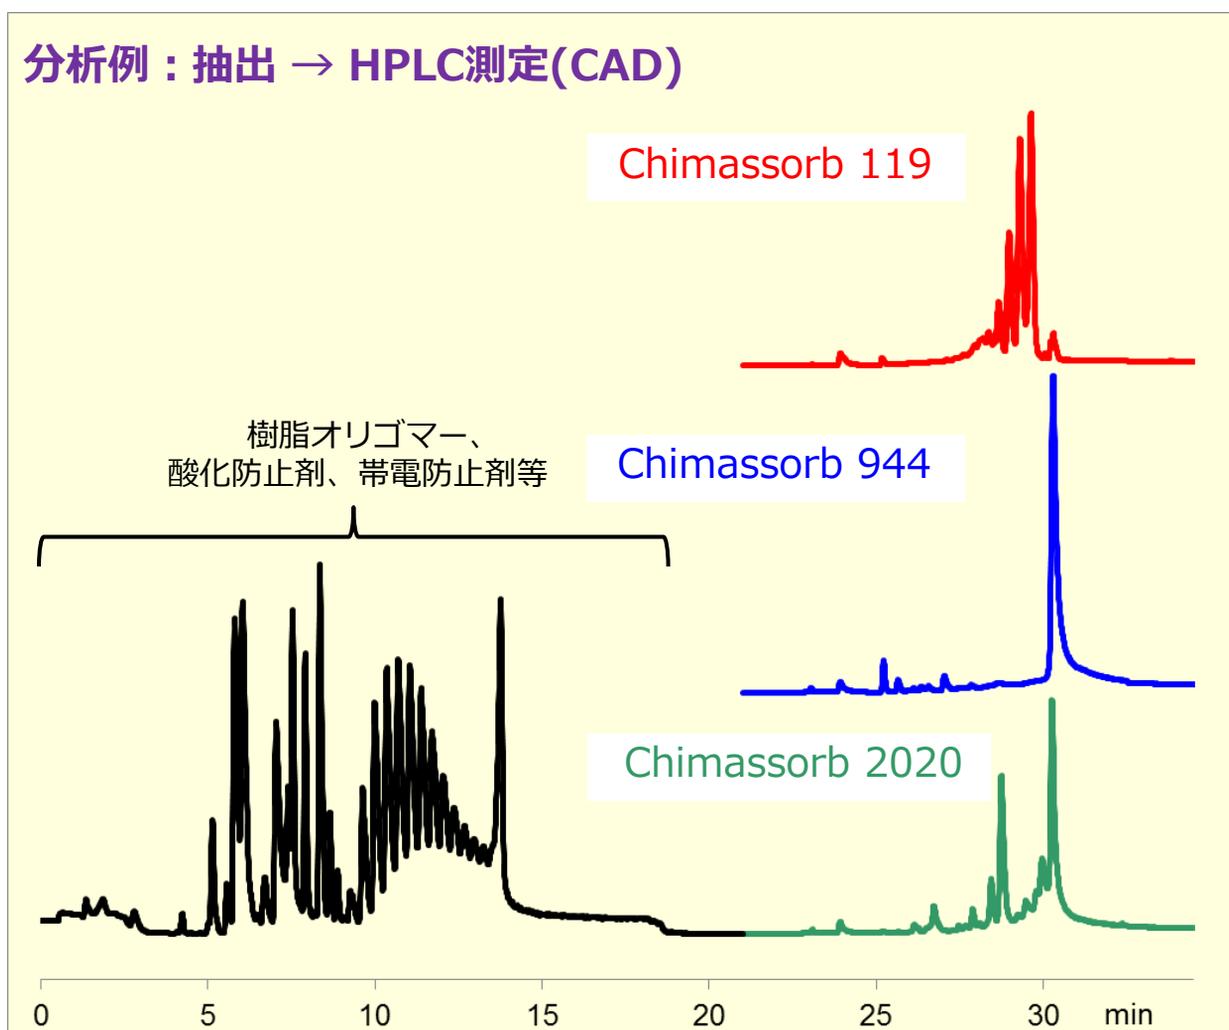

高分子量型HALSが選択的に検出される区分

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.com

FAX: 059-345-7174

URL: <http://www.rhombic.co.jp/>